

ニューモボックス® NPの表示変更のご案内

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ニューモボックス® NPシリンジにつきまして、視認性の向上(含む、接種間違い防止)を目的として個装箱及びブリスターフィルムの表示を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、組成・性状、効能又は効果、用法及び用量は従来品と変わりありません。

何卒ご了承を賜りますとともに、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

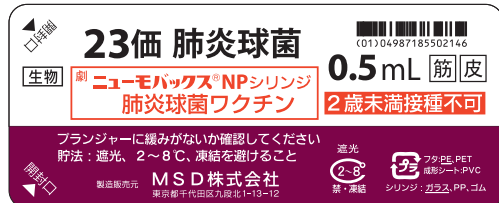
謹白

記

●変更内容

- ・個装箱及びブリスターフィルムの表示を変更いたします。
 - ・各ワクチンの種別・記号を表示いたします。
- 各製品の表示は以降をご覧ください。

●ニューモボックス® NP シリンジの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「23価 肺炎球菌」の表示及び黄色帯を濃い紫色に変更いたします。

●変更品の出荷予定時期

品 名	包 装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ニューモボックス® NPシリンジ	1シリンジ	185-81061-6	W017708	2022年 11月

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございます。

※表示変更と同時に、添付文書同梱廃止品となります。

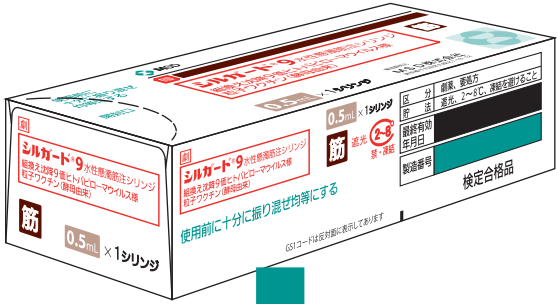
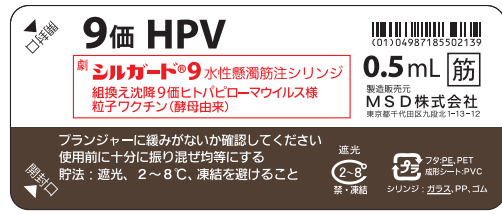
※内面をご覧ください。👉

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

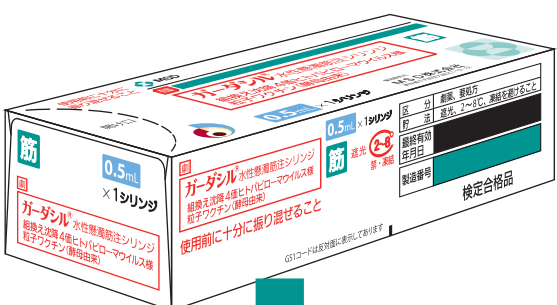
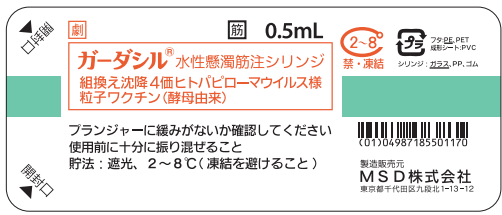
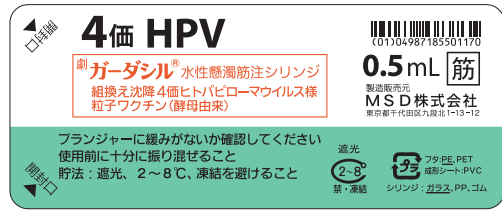
その他の表示変更のご案内

1. シルガード® 9 水性懸濁筋注シリンジの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「9価 HPV」の表示及び茶色帯を表示いたします。

2. ガーダシル® 水性懸濁筋注シリンジの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「4価 HPV」の表示及び緑色帯を表示いたします。

3. ヘプタボックス® - II 水性懸濁注シリンジ0.25mLの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「B型肝炎 0.25」の表示及び灰色帯を濃くいたします。

4. ヘプタボックス® - II 水性懸濁注シリンジ0.5mLの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「B型肝炎 0.5」の表示をいたします。

表示変更のご案内

●変更品表示

当分の間、個装箱には **表示変更品** と表示いたします。

●変更品の出荷予定時期

品 名	包 装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
シルガード® 9 水性懸濁筋注シリンジ	1シリンジ	185-81060-9	未 定	2023年 5月
ガーダシル® 水性懸濁筋注シリンジ	1シリンジ	185-80840-8	W005682	2023年 6月
ヘプタバックス® -Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	1シリンジ	185-81010-4	未 定	2023年 6月
ヘプタバックス® -Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0.5mL	1シリンジ	185-81011-1	未 定	2023年 6月

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございます。
※製造番号及び出荷予定時期につきましては、確定いたしましたら改めてお知らせいたします。ご了承ください。

MSD株式会社
東京都千代田区九段北1-13-12

製品のお問い合わせ先
MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961
＜受付時間＞ 9:00 ～ 17:30 (土日祝日・当社休日を除く)