

最終有効年月日等の表示変更のご案内

ウイルスワクチン類

ヘプタバックス®-II

生物学的製剤基準 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ヘプタバックス®-IIにつきまして、一般社団法人日本ワクチン産業協会における最終有効年月日の識別を高めるための統一的な対応により、最終有効年月日等の表示位置を変更いたします。また、製造番号シールの形状・表示を変更いたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、成分・分量、効能・効果及び用法・用量は従来品と変わりありません。

何卒ご了承を賜りますとともに、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
謹白

記

●変更内容

1. 最終有効年月日、製造番号、検定合格年月日の表示変更

上段から検定合格年月日、最終有効年月日、製造番号の表示を最終有効年月日、製造番号、検定合格年月日の順に変更いたします。

尚、検定合格年月日は6桁(年:西暦下2桁、月:2桁、日:2桁)の表示にいたします。

従来品

検定合格年月日
1234. 56. 78
上:最終有効年月日、下:製造番号
1234. 56. 78
N000000

変更品


最終有効年月日
1234. 56. 78
上:製造番号、下:検定合格年月日
N000000
345678

最終有効年月日等の表示はイメージです。実際の表示とは異なります。


2. 製品名表示の変更

製品名の表示を大きくし、レイアウトを変更いたします。

従来品

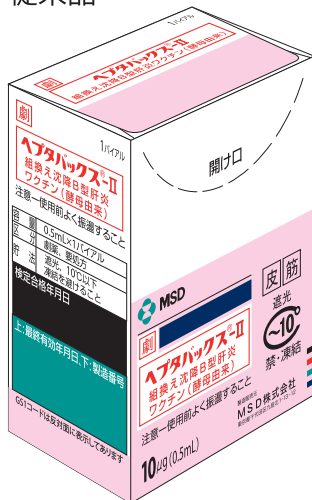

変更品

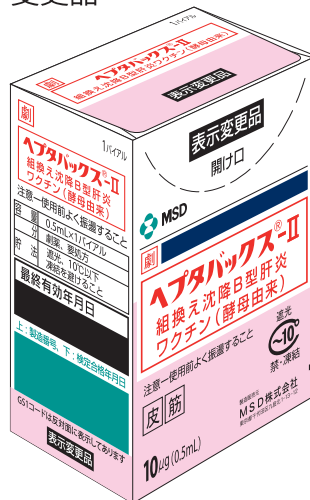

製品名の表示を大きくし、レイアウトを変更しました。

※裏面をご覧ください。👉




MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

最終有効年月日等の表示変更のご案内

3. 製造番号シールの変更

- ・シールの形状及び表示内容を変更いたします。
- ・シールの糊を変更いたします。
- ・シールの大きさに変更はございません。(幅 22mm、高さ 6mm)

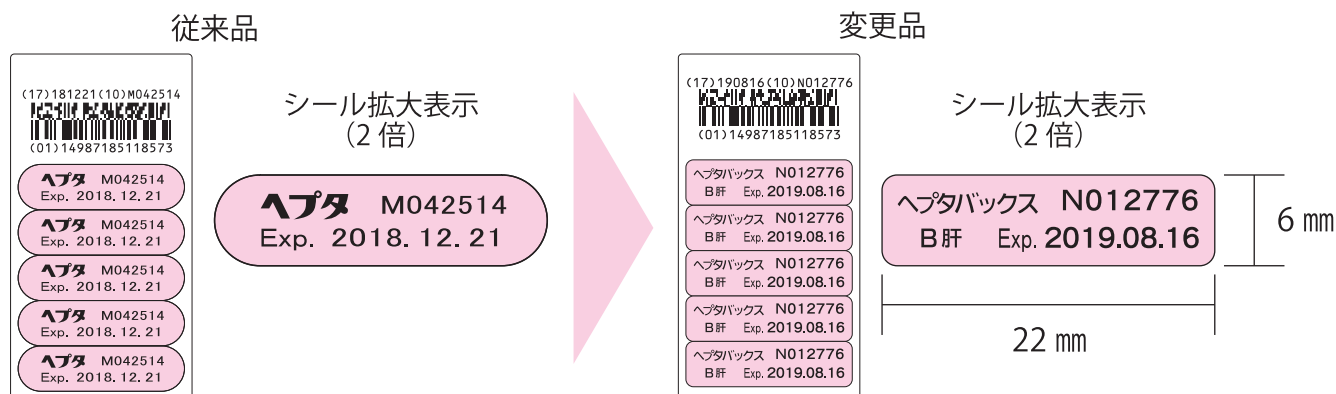

● 変更品表示

当分の間、個装箱には **表示変更品** と表示いたします。段ボール箱には **包装変更品** と記載したテープを使用いたします。

● 変更品の出荷予定時期

品名	包装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ヘプタボックス®-II	0.5mL 1バイアル	185-11857-6	N 0 1 2 7 7 6	2017年10月下旬

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございますが、ご了承ください。



MSD株式会社
東京都千代田区九段北1-13-12

製品のお問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961
<受付時間> 9:00 ~ 17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

HTA-54-05
201709